


## Karotis yama TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Karotis ve femoral prosedürlerde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Yama dacron malzemedan ince örgü tekniğiyle üretilmiş olmalıdır.
3. 0,5 mm'den küçük duvar kalınlığına sahip olmalıdır.
4. Eni en az 6 en fazla 25mm olmalıdır.
5. Uzunluğu 75 veya 120 mm olmalıdır.
6. Yama da tiftiklenme olamamalı bu sayede kullanımı kolay olmalıdır.
7. Dikimi kolay olmalı, özel bir suture malzemesi gerektirmemelidir.
8. Yüzdeyi belirten referans çizgileri olmalıdır.
9. Yama knitted özellikte olmalı su geçirgenliği 120mmHg da 5ml/dk/cm<sup>2</sup> 'den küçük olmalıdır.
10. Yama kolajen kaplı olmalıdır.
11. Kolojen kaplaması yapılırken toksik aldehydler (ör:formaldehid, glutaraldehyd) kullanılmamış olmalıdır.
12. Ürünün dikdörtgen ve bir ucu üçgen yapılı olan seçenekleri olmalıdır.

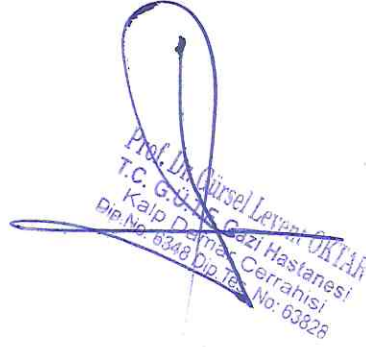

Prof. Dr. Gürsel Levran  
T.C. G.Ü. T.C. Gazi Hastanesi  
Kalp Damar Cerrahisi  
Dip. No: 6348 Dip. Tes. No: 63828