



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 05/10/2020
Bölüm Adı : Radyoloji Anjiyo Stoğu

Döküm Tarihi : 05/10/2020 15:41:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
S-013268 KATETER, DRENAJ, BİLİER / KİLİTLİ, SET / HİDROFİLİK, KİLİTLİ, SET / HİDROFİLİK, KİLİTLİ,

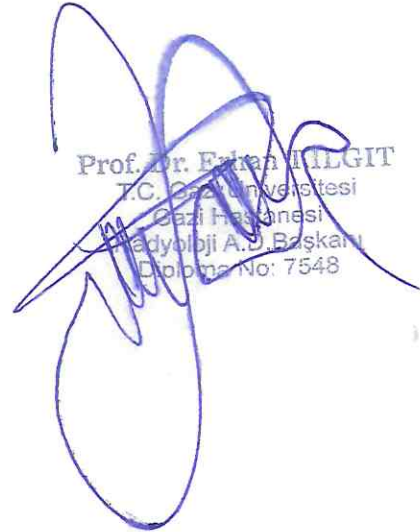
Bilier drenaj kateteri, çok delikli, 8 Fr-10F-12F Teknik Şartnamesi

Sut Kodu: GR1222

Sipariş Kodu: S-013268

- 1) Kateter 8 Fr-10F-12F kalınlığında olmalıdır. Kateter uzunlukları 35-50 cm arasında olmalıdır.
- 2) 0,038 " kılavuz tele uygun olmalıdır.
- 3) Kateter bükülme/kırılma direnci yüksek olmalıdır.
- 4) Kateter ucu tapered (distale doğru incelme) olmalıdır.
- 5) Kateterle birlikte distale iletimi sağlayan metal ve plastik taşıyıcı koaksiyel parçalar bulunmalıdır.
- 6) Kateter arkasında musluk olmalıdır.
- 7) Kateterin ipli kilit sistemi bulunmalıdır.
- 8) Kateterler çok delikli olmalıdır.
- 9) Tekli steril paketler halinde olmalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon son kullanım tarihleri yazılı olmalıdır.
- 10) Teslim tarihinden itibaren en az bir yıllık sterilizasyon kullanım süresi olmalıdır.
- 11) Firma kullanım süresi bitiminden iki ay önce başvurulduğunda ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.


Doç. Dr. Mehmet Koray AKKAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Radyoloji
Dipl. No: 12991 Dlp. No: 103641


Prof. Dr. Erhan İLİGİT
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Radyoloji A.B. Başkanı
Diploma No: 7548

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN