

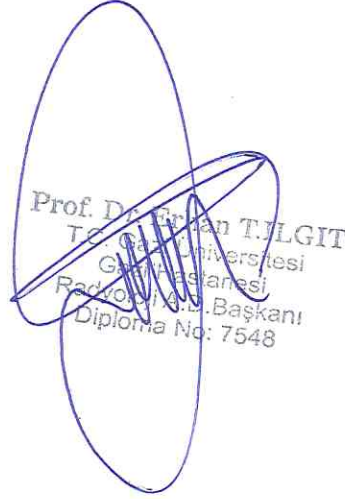
## İnflatör (balon şişirme amaçlı)/ Deflatör Teknik Şartnamesi

Sut Kodu: GR1241

Sipariş Kodu: S-013287

- 1) Dayanıklı plastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Yapısı şeffaf olmalı, sıvı ve hava kabarcıklarının görülmesine imkan vermemelidir.
- 3) Uç kısımdaki uzatma, basınca dayanıklı ve ucu rotating adaptörlü luerlock olmalıdır.
- 4) Sıvı kapasitesi 20 cc.'den düşük olmamalıdır.
- 5) Pistonu hassas olmalı balonu şişirme/indirme sırasında tutukluk yapmamalıdır.
- 6) Manometre basınç aralığı 0-25 atm arasında ayarlanabilmelidir.
- 7) Manometre ayarları hassas olmalı ve hassasiyet değeri +/- % 3'den iyi olmalıdır.
- 8) Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 9) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
- 10) Firma kullanım süresi bitiminden iki ay önce başvurulduğunda ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

  
Doç. Dr. Mehmet Koray AKMAN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Radyoloji  
Dış.No: 12801 Dış.Tes.No: 103001

  
Prof. Dr. Erhan TILGİT  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Radyoloji A.B. Başkanı  
Diploma No: 7548